EFFECT

Radiofrequência compacto de alta potência

Potência de 100 W

Resultados visíveis que se mantêm a longo prazo

Alto efeito terapêutico não invasivo

Trata qualquer fototipo de pele

Fácil manuseio e programação

Design moderno e inovador

Equipamento utilizado com ou sem o gabinete, tornando-se portátil para atendimentos domiciliares.

Menor preço, maior valor agregado

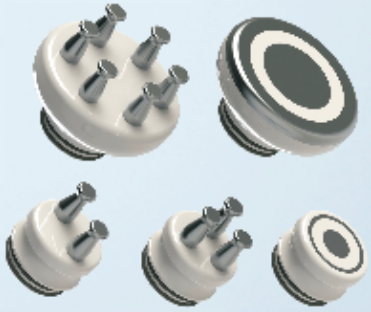

Garantia estendida HTM

Registro ANVISA 80212480015

Poderoso aliado no combate da celulite, flacidez de pele, gordura localizada, rugas e estrias!

HTM
PENSANDO TECNOLOGIA
PRODUZINDO QUALIDADE.

Effect

Conheça o EFFECT

Código: 004279

A seguir conheça os acessórios inclusos e
e as possibilidades de acessórios opcionais.

Visão Geral

Parte frontal

Parte traseira

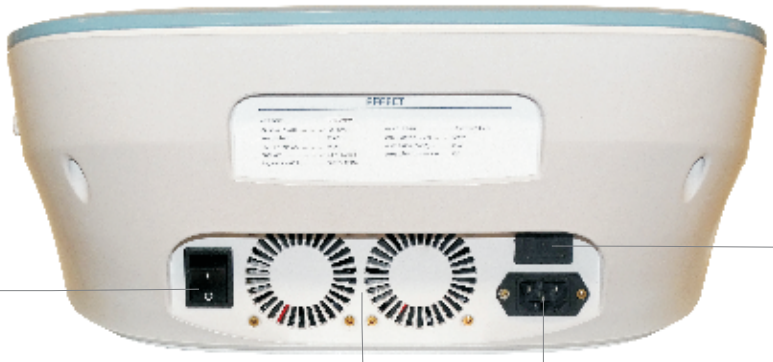
Porta fusível
Chave liga-desliga
Entrada para o cabo de força
Saída de ar
Saída de ar responsável pela refrigeração do equipamento

Acessórios

Confira abaixo quais são os acessórios que acompanham o seu equipamento.

Acessórios Inclusos

	código	nome	quant.	descrição
		Cabo de Força 3x1mm2	1 unid.	Cabo de força para conexão a rede elétrica.
		Aplicador Corporal/ Facial	1 unid.	Aplicador que permite a utilização de ponteiras corporais e faciais.
		Ponteira Corporal Concêntrica	1 unid.	Possui maior concentração do campo eletromagnético, proporciona maior percepção de aquecimento e é indicada para o tratamento de regiões maiores.
		Ponteira Corporal Hexapolar	1 unid.	Com maior área de contato sobre o tecido é indicada para o tratamento de regiões corporais maiores.
		Ponteira Facial Bipolar	1 unid.	Principal característica é a concentração de energia entre seus dois eletrodos. É indicada para aplicações mais precisas.
		Ponteira Facial Tripolar	1 unid.	Concentra o campo eletromagnético entre seus três polos e tem alta percepção de aquecimento, é indicada para o tratamento das regiões de tríceps, bíceps e mamas.
		Ponteira Facial Concêntrica	1 unid.	Possui maior concentração do campo eletromagnético, proporciona maior percepção de aquecimento e é indicada para os tratamento da região frontal, mãos e etc.
		Suporte do Aplicador Corporal/Facial	1 unid.	Suporte para aplicador
		Termômetro Infravermelho	1 unid.	Termômetro Infravermelho para medição da temperatura
		Banner 0,80 x 0,50m	1 kit.	Utilizado para divulgação do equipamento
		Take One	1 unid.	Utilizado para divulgação do equipamento
		Toalha HTM	1 unid.	Utilizado para divulgação da marca
		Tubo de Gel (RESOL/ANVS 343/05)	1 unid.	Gel glicerinado
		DVD com manual de instruções	1 unid.	Manual de instruções do equipamento

Effect

Acessórios

Confira abaixo quais são os acessórios que não acompanham seu equipamento.

Acessórios Opcionais

Este acessório deve ser adquirido separadamente.

	código	nome	quantidade	descrição
		Rack HTM	01 uni	Rack de metal HTM com rodízios que permitem um giro de 360º permitindo uma fácil locomoção.
		Chave fixa 8mm	01 uni	Chave para auxiliar na montagem do rack

Effect

Indicações e Técnicas de Aplicação

O EFFECT® é um equipamento com controle totalmente digital que foi construído para trabalhar com um aplicador e cinco ponteiras individuais para tratamentos faciais e corporais. Além disso, possui display touch screen de 5" para configuração dos parâmetros de aplicação de modo fácil, rápido e interativo.

Indicações	Principais Características
-Rejuvenescimento facial -Olheiras e linhas de expressão -Cicatrizes de acne -Flacidez de pele -Remodelamento corporal -Estrias -Celulite -Rugas -Gordura localizada -Cicatrizes -Fibrose -Retrações -Aderências -Acne vulgar e suas cicatrizes.	Menor preço, maior valor agregado Trata a flacidez de pele, celulite e gordura localizada. Resultados visíveis que se mantêm a longo prazo Alto efeito terapêutico não invasivo Trata qualquer fototipo de pele Não interfere na rotina diária do cliente Equipamento utilizado com ou sem o gabinete, tornando-se portátil para atendimentos domiciliares. Aplicadores leves e ergonômicos gerando conforto e praticidade Potência de 100 W Programação super intuitiva Radiofrequência para tratamentos corporais e faciais com frequências de 1,2 MHz e 2,4 MHz e potência de 100W. Multipolar com 5 ponteiras, sendo 3 faciais e 2 corporais.Auxília na perda de medidas.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

1)Remova todo e qualquer objeto de metal que estiver em contato direto com a pele do paciente, na região do tratamento, além de qualquer dispositivo eletrônico.

2)Higienize a área de tratamento

3)Antes do início da aplicação deve-se aferir a temperatura da região com o termômetro infravermelho.

4)Em aplicações faciais dividir a região a ser trabalhada em quadrantes, tais como frontal, hemiface direita, hemiface esquerda e pescoço. Para as áreas corporais,dividir a região a ser trabalhada em quadrantes conforme necessidade.

5)Conecte o aplicador no equipamento, e selecione a região de tratamento correspondente.

6)Selecione o tempo de manutenção da temperatura no equipamento.

7)Distribua o gel glicerinado por toda a região de tratamento.

8)Inicie a aplicação apertando a tecla Start no equipamento ou no aplicador.

9)Aumente a intensidade de acordo com a percepção do paciente sobre a temperatura, considerando principalmente a temperatura terapêutica.

10)A técnica de aplicação baseia-se em movimentos constantes para que a distribuição da energia seja uniforme por todo o tempo de tratamento. O aplicador nunca deve ficar estacionado no local, havendo risco de queimaduras.

11)Utilizando o termômetro infravermelho, monitore a temperatura.

12)Após o alcance da temperatura terapeutica acione o tempo de manutenção do tratamento através da tecla Start/Timer. Dessa forma o tempo programado regredirá e ao final o aparelho desligará automaticamente.

Protocolos

SUGESTÕES DE TRATAMENTOS

Protocolo Redução de Medidas

1)Higienizar a região de tratamento com gel esfoliante físico, realizando suave massagem circular.

2)Borrifar água e remover.

3)Delimitar a área de tratamento em quadrantes com auxílio de um lápis dermográfico. Realize a aplicação em um quadrante por vez para maior controle da temperatura.

4)Selecionar no Effect a região de tratamento.

5)Verificar a temperatura da região de tratamento utilizando termômetro infravermelho antes de iniciar a aplicação.

6)Aplicar o gel glicerinado, que acompanha o Effect , de forma homogênea em toda a área de aplicação.

7)Determinar o tempo de manutenção da temperatura. Recomenda-se a manutenção da temperatura de 3 a 5 minutos/área.

8)Selecionar a frequência de tratamento. Recomenda-se o uso de frequências mais baixas.

9)Apertar a tecla Start na Tela ou no aplicador, e iniciar a aplicação. Ela deve ser feita por quadrantes e com movimentos constantes para que a distribuição da energia seja uniforme por todo o tempo de tratamento.

10)Aumentar a intensidade de forma gradativa conforme a percepção do paciente, considerando a temperatura terapêutica desejada.

11)Monitorar a temperatura utilizando o termômetro infravermelho, aumente ou diminua a intensidade até o alcance da temperatura terapeutica.

12)Ao alcançar a temperatura de 40°C, acione o tempo de manutenção do tratamento através da tecla Start/Timer na tela ou no aplicador. Dessa forma o tempo programado regredirá e ao final o aparelho desligará automaticamente.

13)Finalizar aplicando creme de massagem com ativos lipolíticos, e realizar massagem estimulante.

Protocolo Rejuvenescimento Facial

1)Higienizar toda a face com sabonete esfoliante físico realizando suave massagem circular.

2)Borrifar água e remover.

3)Tonificar com loção Tônica

4)Conectar o Aplicador Facial no Effect

5)Selecionar no Effect a região de tratamento Facial.

6)Verificar a temperatura da região de tratamento utilizando o termômetro infravermelho antes do início da aplicação.

7)Aplicar o gel glicerinado, que acompanha o Effect , de forma homogênea em toda a área de aplicação.

8)Determinar o tempo de manutenção da temperatura. Recomenda-se a manutenção da temperatura de 5 minutos/área.

9)Selecionar a frequência de tratamento. Recomenda-se o uso de frequências mais altas.

10)Apertar a tecla Start na Tela ou no aplicador, e iniciar a aplicação. Ela deve ser feita por regiões e com movimentos constantes para que a distribuição da energia seja uniforme por todo o tempo de terapia.

11)Aumentar a intensidade de forma gradativa conforme a percepção do paciente, considerando a temperatura terapêutica desejada.

12)Monitorar a temperatura utilizando o termômetro infravermelho, aumente ou diminua a intensidade até o alcance da temperatura terapeutica.

13)Ao alcançar a temperatura de 41°C, acione o tempo de manutenção do tratamento através da tecla Start/Timer na tela ou no aplicador. Dessa forma o tempo programado regredirá e ao final o aparelho desligará automaticamente.

14) Aplicar um Blend com DMAE e Sérum Revitalizante

15)Ao término do tratamento aplicar uma camada de máscara calmante e aguardar 15 minutos.

16)Retirar a máscara e finalizar com filtro de proteção solar.

Instalação do Produto

1) Conecte o cabo de força ao seu equipamento e o equipamento a uma tomada 110V ou 220V.

2) Conecte o cabo de força ao seu equipamento.

3) Ligue seu equipamento.



4) Conecte o aplicador.

5) Finalize a montagem.

Detalhe de Montagem

Conecte a ponteira, pressionando-a para dentro.
Observando o alinhamento dos dois pinos com os furos.

Effect

Cuidados com o aparelho

CUIDADOS TÉCNICOS

Antes de ligar o equipamento, certifique-se que está ligando-o conforme as especificações técnicas localizadas na etiqueta do equipamento.

Um paciente que utilize dispositivo eletrônico implantado (por exemplo, marca-passo cardíaco) não deverá ser sujeito a tratamento de radiofrequência, a menos que uma opinião médica especializada tenha sido anteriormente obtida.

Não abra o equipamento e os aplicadores em hipótese alguma, pois, além de perder a garantia, você estará pondo em risco a sua segurança e poderá danificar componentes caros. Qualquer defeito, contate a HTM Eletrônica que informará a Assistência Técnica Autorizada HTM Eletrônica mais próxima de você.

Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado na etiqueta do equipamento.

Não introduza objetos nos orifícios do equipamento e aplicadores e não apoie recipientes com líquidos sobre o equipamento.

Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de força. Ainda para aumentar a vida útil dos cabos dos aplicadores, não os desconecte do equipamento puxando pelos fios;

Manuseie os aplicadores com cuidado, pois impactos mecânicos podem danificá-los.

Inspecione constantemente o cabo de força e os cabos dos aplicadores principalmente próximo aos conectores, verificando se existe presença de cortes na isolação dos mesmos.

CUIDADOS COM A LIMPEZA:

Para limpar o equipamento utilize um pano seco. Agindo assim você estará conservando seu equipamento. Sempre limpe os aplicadores após a utilização para evitar o acúmulo de gel.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos a condensação.

Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura superior a 60°C ou inferior a -20°C.

Não exponha o equipamento direto aos raios de sol, chuva ou umidade excessiva.

CUIDADOS NO TRANSPORTE

Se houver necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo processo de embalagem utilizado pela HTM Eletrônica. Procedendo desta forma, você estará garantindo a integridade do equipamento. Para isso, aconselha-se que a embalagem do equipamento seja guardada.

Dúvidas mais comuns

Como funciona o sistema bifrequencial e multipolar?

O EFFECT oferece a tecnologia da Radiofrequência Bifrequencial, as frequências disponíveis no equipamento são 1,2 MHz e 2,4 MHz., onde o profissional pode selecionar a frequência mais indicada para cada tratamento, desta forma utilizando freqüências mais baixas a temperatura terapêutica é alcançada de forma gradual, são indicadas para o alcance de tecidos mais profundos, em contrapartida frequências mais altas proporcionam um "choque térmico" e são utilizadas para tecidos mais superficiais.

Além disso, o equipamento possui a tecnologia Multipolar, que proporciona ao profissional aplicador aplicadores que podem ser selecionados de acordo com a região, corporal ou facial, abrangendo todas as regiões de tratamento de forma eficaz, garantindo segurança, resultados e conforto ao cliente.

Como o EFFECT Funciona ?

O objetivo do tratamento é aumentar a temperatura do tecido em torno de 38° C a 42° C, desencadeando uma sequência de reações fisiológicas que geram contração das fibras de colágeno e retração da pele, evidenciando um efeito lifting. E a longo prazo estimula a formação de um novo colágeno. Além disso, o aquecimento tecidual também proporciona um aumento da circulação sanguínea e linfática, melhorando o aporte de nutrientes e oxigênio das células.

Durante a aplicação a temperatura é monitorada através de um termômetro infravermelho, podendo variar de 3 a 5 minutos de aplicação por região, desta forma o tempo total de aplicação varia de acordo com a área corporal.

A visualização dos resultados é rápida?

O EFFECT oferece um tratamento eficaz e com resultados visíveis logo na 1ª sessão, promovendo um lifting facial, e melhorando o tônus da pele. Com o passar das sessões ocorre uma melhora duradoura dos resultados. Mas para a efetividade do tratamento, recomendamos que sejam realizadas todas as sessões que o profissional indicar para o seu caso.

Qual a duração de cada sessão?

Em média as sessões tem duração de 30 minutos, podendo variar de acordo com a região a ser tratada.

Quantas sessões são necessárias?

Recomendamos a realização de 4 a 6 sessões, com intervalos de 7 a 15 dias entre elas, podendo variar conforme o quadro clínico e a evolução de cada paciente. São necessárias, pelo menos 4 sessões de manutenção com intervalos estipulados pelo profissional.

O que sinto durante o tratamento?

O tratamento pode ser realizado em qualquer época do ano sem alterar sua rotina diária, é indolor e não invasivo, promove uma sensação de aquecimento controlado e vermelhidão (eritema) no local da aplicação, que desaparecem em pouco tempo.

O EFFECT possui quais indicações?

O EFFECT também pode ser utilizado para tratamentos de cicatrizes e aderências, fibrose, contraturas musculares, fibromialgia, entre outros.

Quais as ponteiras que acompanham o EFFECT?

Acompanham 5 ponteiras, 2 corporais: concêntrica e hexapolar e 3 faciais: bipolar concêntrica, bipolar longitudinal e tripolar.

Características Técnicas

Equipamento: **Effect**
Origem: **HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda**
Nome técnico e função: **Equipamento de Rádio Frequência para estética**

Tensão AC de Alimentação:	100-220V~ ±10%
Frequência da Tensão de Alimentação:	50/60Hz ±10%
Fusível de Proteção (20 x 5mm) 20AG-T:	5A / 250V~
Potência de Entrada:	400VA ±10%
Modo de Emissão:	Contínuo
Frequência de Emissão:	1,2 e 2,4 MHZ ±10%
Potência de Saída (BODY):	100W ±20%
Potência de Saída (FACE):	50W±20%
Impedância Nominal:	50Ω±10%
Timer:	1mim a 60mim ±10%
Peso do Equipamento sem Acessórios (Parte Superior):	3,30Kg
Peso da Parte Inferior (acessório opcional):	11kg
Dimensões Parte Superior (LxAxP):	383x205x330mm
Dimensões Parte Inferior (LxAxP):	450x840x440mm
Temperatura de Armazenamento:	-20°C a 60°C
Embalagem para Transporte:	Utilizar a original
Número de Canais de Saída:	1 canal
Faixa de umidade relativa do ar recomendada para armazenamento e transporte:	10 a 60%